



BEAR Medic Corporation

Yushima BEAR-Bldg., Yushima2-31-24, Bunkyo-ku, Tokyo
113-0034, JAPAN
TEL 03-3818-4041 FAX 03-3818-4042

株式会社ベアーメディック

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-24 湯島ベアービル
TEL 03-3818-4041 FAX 03-3818-4042

2017年3月吉日

お客様各位

株式会社ベアーメディック
東京都文京区湯島 2-31-24
TEL : 03-3818-4041

脳神経外科用インプラント化粧箱と製品包装形態変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、日頃ご使用、御取扱い頂いております脳神経外科用滅菌済みインプラント製品の化粧箱を変更することとなりましたのでご案内申し上げます（一部製品は対象除外といたします）。

併せて未滅菌インプラントの製品包装形態を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

化粧箱変更がされる製品は、滅菌済み脳神経外科用インプラント（プレート・スクリュー）となります。

化粧箱の大きさを現行製品より小さくさせていただきます。

また現行製品は化粧箱にシュリンクフィルム処理をさせていただいておりますが、今後はシュリンクフィルムを廃止し、開封シールを貼った状態でご提供させていただきます。

製品包装形態の変更をさせていただく製品は、脳神経外科用未滅菌インプラントとなります。

現行の製品包装形態は脱気袋に製品を入れ、空気を抜いた状況でご提供しております。

今後は脱気袋を廃止し、チャック付のビニール袋に製品を入れた状態でご提供させていただきます。

なお、化粧箱と包装形態が変更された製品につきましては、今までと製品品質の変更はございません。
化粧箱の変更、未滅菌製品の包装形態変更の移行につきましては、**3月21日の製造分**から順次切り替えていく予定でございます。

変更となる製品の形状につきましては、下記画像にてご確認いただきますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら、書面にて御案内申し上げます。

敬具



記


【変更内容】

- ・化粧箱が小さくなります（滅菌済みインプラント）。 ※一部製品を除く
- ・シュリンクフィルムを廃止し、開封シール処理といたします（滅菌済みインプラント）。
- ・未滅菌インプラントの包装形態を変更します（脱気包装形態からチャック付ビニール袋へ変更）。

化粧箱の変更（滅菌済みインプラント）



化粧箱シュリンク変更（滅菌済みインプラント）

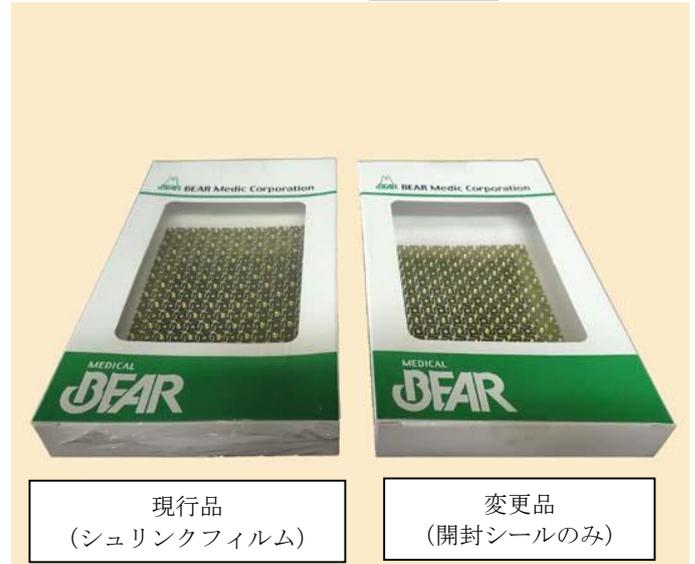

包装形態変更（未滅菌チタンプレート）




包装形態変更（未滅菌スクリュー）






【化粧箱変更除外製品】 ※現行品と同じサイズの化粧箱


- 40676-S
- 40676-SA-ST

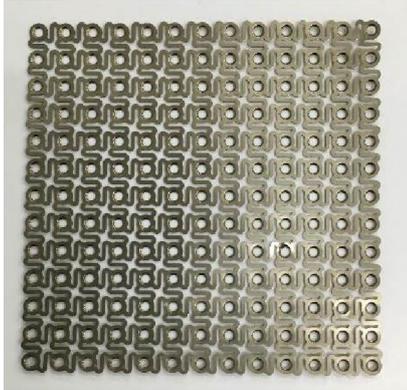


- 60670-ST
- 60670-SA-ST

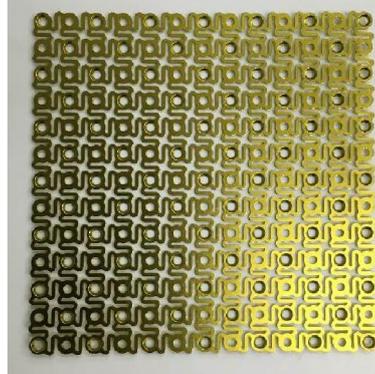

- 40410-ST

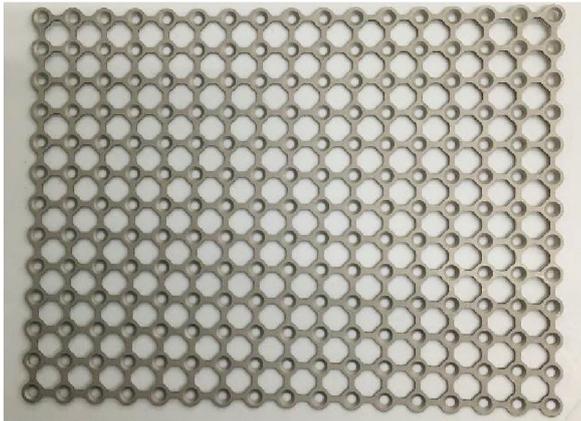


- 50610-ST

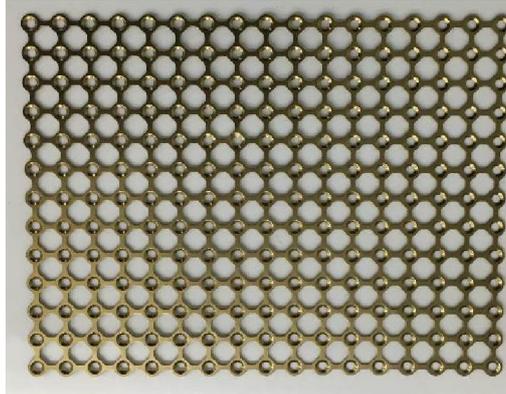

- 60380-ST



- 60480-ST

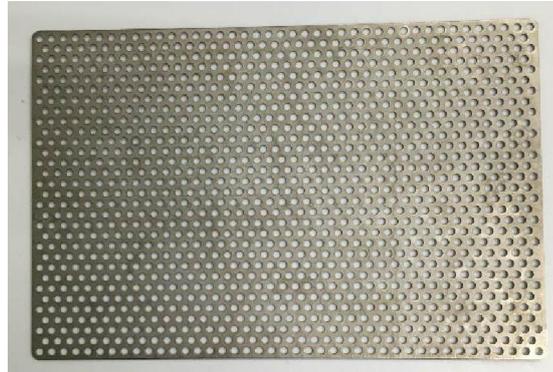

- 60416-ST



- 60030-ST

